Kett

SCIENCE OF SENSING

米麦単粒水分仪
PQ-520

株式会社KETT科学研究所

米麦单粒水分仪 PQ-520

“米麦单粒水分仪 PQ-520” 是一款能够逐粒、快速且连续测量样品水分的仪器。通过采用这种测量方式，可准确掌握大量样品的水分分布情况。因此，该仪器可用于判断谷物最佳收割期、管控交货样品的平均水分值、防止干燥调整时水分不均等多种场景。

测量操作简洁易行：只需将样品倒入宽口样品投入口，按下“Start·Stop”键键即可。测量完成后，平均水分值将自动显示。水分分布情况也可通过一键操作直观呈现。

通过逐粒检测掌控整体水分分布——这种简洁可靠的方法，为提升稻麦品质提供有效助力。

● 易懂的画面、易懂的直方图

画面使用了可视性高的荧光显示管。
测量后显示平均水分值，还可以显示表示水分分布的直方图。
直方图显示可以直观地把握样品整体的水分分布，也可以容易地发现干燥不均。

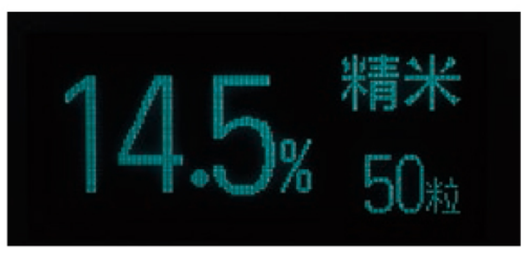

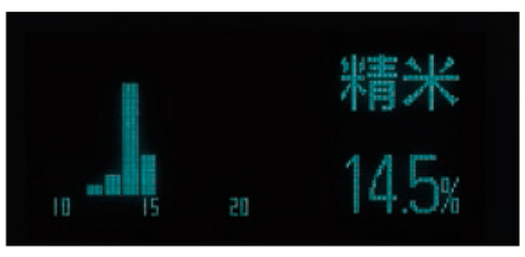

● 易于维护

测量后排出样品的样品盒容量大，因此不需要每次测量后丢弃样品。此外，当样品搬运部堵塞时，可打开主体侧门轻松清洁。

样品盒

清洁仪器侧门

● 记录管理

测量的日期和时间，水分数据，标准偏差和直方图可以打印到可选的打印机。
另外，通过使用数据记录软件，也可以在PC上进行数据管理。

打印机VZ-380（可选）

■ 规 格

测量方式	电阻式
测量对象范围	精米：11～20%　糙米：11～20% 稻谷：11～35%　大麦：10～40% 小麦：10～40%　麦粒：10～35%
测量时间	40秒以下/100粒 （糙米测定、平均水分的显示时间）
测量精度	±0.5%（水分20%以下）
统计计算	平均值、标准差(仅限打印)
显示方法	荧光显示管
显示内容	选择的谷类、平均水分值、粒数、时刻、水分分布（矩形图）
温度补正	热敏电阻自动温度补正（仪器温度补正）
设定粒数	10～1000粒（任意设定）
使用温湿度范围	5～40°C、85% RH以下
外部输出	RS- 232C（打印机用）、USB（PC用）
电源	AC100V-240V（50/60Hz）
消耗电力	最大76W
尺寸、重量	320（W）×254（D）×382（H）mm、9.0kg
附属品	镊子、勺子、电源线
选配件	打印机VZ-380、数据记录器软件「PDL- 01」

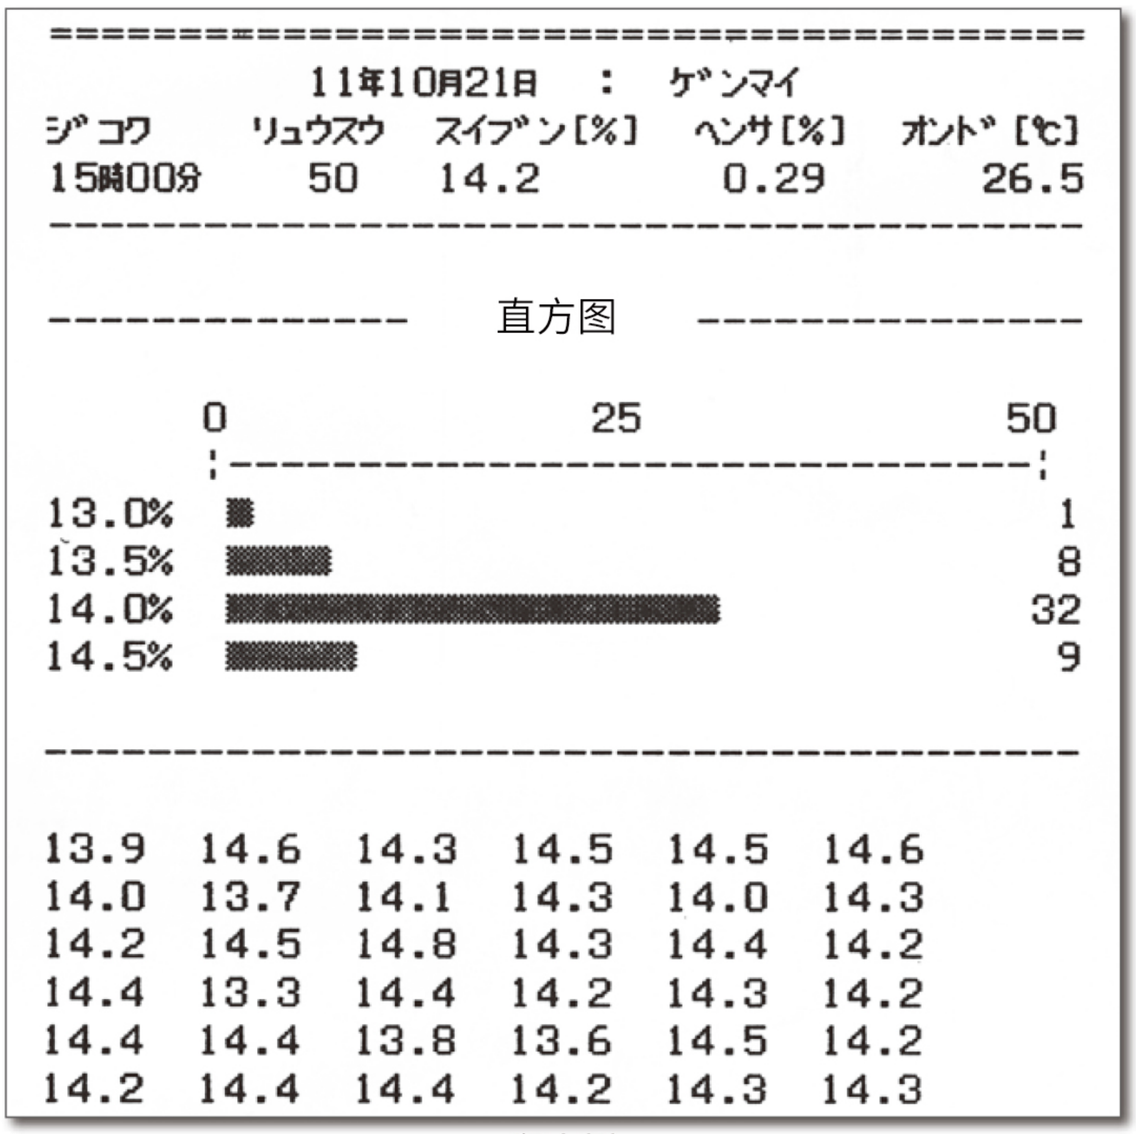

11年10月21日　：　ゲンマイ

ジコク	リュウスウ	スイブン[%]	ヘンサ[%]	オンド[℃]
15時00分	50	14.2	0.29	26.5

直方图

13.9	14.6	14.3	14.5	14.5	14.6
14.0	13.7	14.1	14.3	14.0	14.3
14.2	14.5	14.8	14.3	14.4	14.2
14.4	13.3	14.4	14.2	14.3	14.2
14.4	14.4	13.8	13.6	14.5	14.2
14.2	14.4	14.4	14.2	14.3	14.3

印字例

Kett

株式会社ケツト科学研究所

中国总代理 北京和信昌吉科技发展有限公司

地址 北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座622室

电话 010-64462809 13911731393 13718228855

http://www.kett.com.cn

kett水分仪

为了改良产品，有可能在没有预告的情况下变更规格和外观的一部分。
另外，产品的色调因为印刷的原因可能会与实物不同，请谅解。